

10 IME-DC BLUTGLUCOSE- TESTSTREIFEN	Code	Verfallsdatum	
		Öffnungsdatum	
		Lot Nummer LOT	
		Zielwert	Zielbereich
		Level 1	mg/dL mmol/L
Level 2	mg/dL mmol/L	mg/dL mmol/L	

Nur zur Anwendung mit **IME-DC** Blutzuckermessgeräten.

IME-DC
 Int. Medical Equipment Diabetes Care
 IME-DC GmbH
 Fuhrmannstraße 11
 95030 Hof | Germany
 Tel: +49 9281 | 85 01 6-0
 E-Mail: info@imedc.de
 Web: www.imedc.de

P001040DEXX0203DE00X

IVD Für die Selbstanwendung | IN-VITRO-DIAGNOSTIKUM

25 IME-DC BLUTGLUCOSE- TESTSTREIFEN	Code	Verfallsdatum	
		Öffnungsdatum	
		Lot Nummer LOT	PZN 03941430
		Zielwert	Zielbereich
		Level 1	mg/dL mmol/L
Level 2	mg/dL mmol/L	mg/dL mmol/L	

Nur zur Anwendung mit **IME-DC** Blutzuckermessgeräten.

IME-DC
 Int. Medical Equipment Diabetes Care
 IME-DC GmbH
 Fuhrmannstraße 11
 95030 Hof | Germany
 Tel: +49 9281 | 85 01 6-0
 E-Mail: info@imedc.de
 Web: www.imedc.de

P001043DEXX0203DE00X

IVD Für die Selbstanwendung | IN-VITRO-DIAGNOSTIKUM

50 IME-DC BLUTGLUCOSE- TESTSTREIFEN	Code	Verfallsdatum	
		Öffnungsdatum	
		Lot Nummer LOT	PZN 03941430
		Zielwert	Zielbereich
		Level 1	mg/dL mmol/L
Level 2	mg/dL mmol/L	mg/dL mmol/L	

Nur zur Anwendung mit **IME-DC** Blutzuckermessgeräten.


IME-DC
 Int. Medical Equipment Diabetes Care
 IME-DC GmbH
 Fuhrmannstraße 11
 95030 Hof | Germany
 Tel: +49 9281 | 85 01 6-0
 E-Mail: info@imedc.de
 Web: www.imedc.de

P001042DEXX0203DE00X

IVD Für die Selbstanwendung | IN-VITRO-DIAGNOSTIKUM

IME-DC GmbH
 Fuhrmannstraße 11
 D-95030 Hof
 Germany
 Tel: +49 (0) 9281 / 85 01 6-0
 Fax: +49 (0) 9281 / 85 01 6-100
 info@imedc.de
 Web: www.imedc.de


IME-DC
 Int. Medical Equipment Diabetes Care

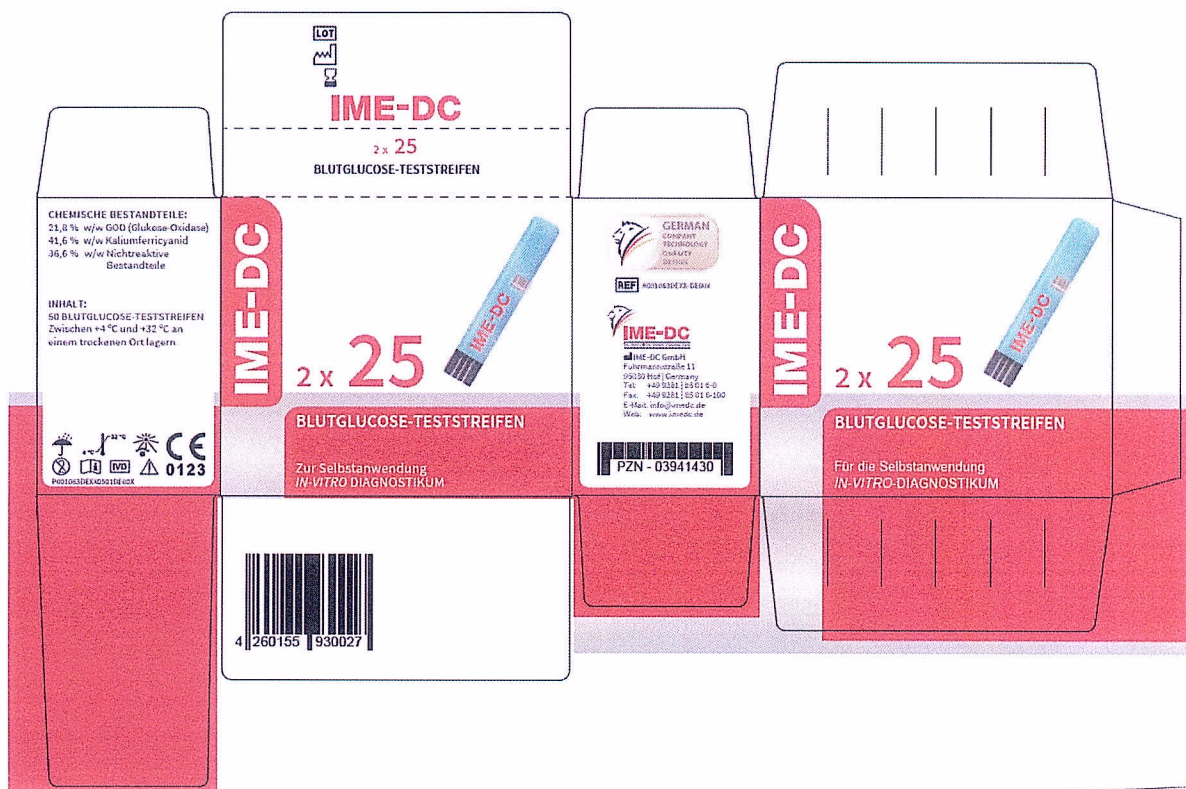

IME-DC GmbH
Führmannstraße 11
D-95030 Hof
Germany
Tel: +49 (0) 9281 / 85 01 6-0
Fax: +49 (0) 9281 / 85 01 6-100
info@imedc.de
Web: www.imedc.de

IME-DC
Inf. Medical Equipment Diabetes Care

M. Pfl

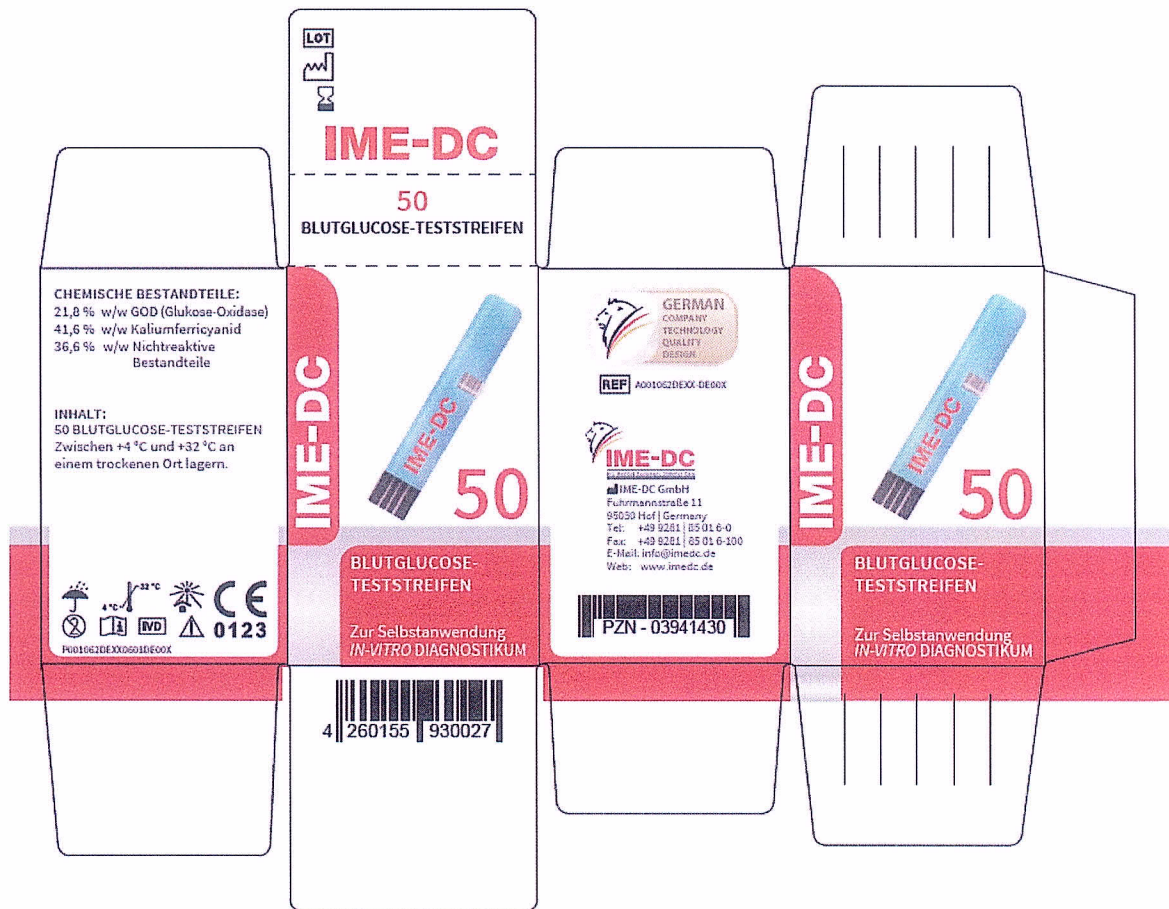


IME-DC GmbH
 Fuhrmannstraße 11
 D-95030 Hof
 Germany
 Tel: +49 (0) 9281 / 85 01 6-0
 Fax: +49 (0) 9281 / 85 01 6-100
 info@imedc.de
 Web: www.imedc.de

IME-DC
 Int. Medical Equipment Diabetes Care

K. Sporn

iDia 10 BLUTGLUCOSE-TESTSTREIFEN

Nur zur Anwendung mit
iDia Blutzuckermess-
geräten.



P003040DEXX0301DE00X



IME-DC
Int. Medical Equipment Diabetes Care

IME-DC GmbH
Fuhrmannstraße 11
95030 Hof | Germany
Tel: +49 9281 | 85 01 6-0
E-Mail: info@imedc.de
Web: www.imedc.de


IVD Für die Selbstanwendung | **IN-VITRO-DIAGNOSTIKUM**

OHNE CODIERUNG

Verfallsdatum		
Öffnungsdatum		
Lot Nummer LOT		
Zielwert		Zielbereich
Level 1	mg/dL mmol/L	mg/dL mmol/L
Level 2	mg/dL mmol/L	mg/dL mmol/L

iDia 25 BLUTGLUCOSE-TESTSTREIFEN

Nur zur Anwendung mit
iDia Blutzuckermess-
geräten.



P003044DEXX0301DE00X



IME-DC
Int. Medical Equipment Diabetes Care

IME-DC GmbH
Fuhrmannstraße 11
95030 Hof | Germany
Tel: +49 9281 | 85 01 6-0
E-Mail: info@imedc.de
Web: www.imedc.de


IVD Für die Selbstanwendung | **IN-VITRO-DIAGNOSTIKUM**

OHNE CODIERUNG

Verfallsdatum		
Öffnungsdatum		
Lot Nummer LOT		
Zielwert		Zielbereich
Level 1	mg/dL mmol/L	mg/dL mmol/L
Level 2	mg/dL mmol/L	mg/dL mmol/L

iDia 50 BLUTGLUCOSE-TESTSTREIFEN

Nur zur Anwendung mit
iDia Blutzuckermess-
geräten.



P003042DEXX0301DE00X



IME-DC
Int. Medical Equipment Diabetes Care

IME-DC GmbH
Fuhrmannstraße 11
95030 Hof | Germany
Tel: +49 9281 | 85 01 6-0
E-Mail: info@imedc.de
Web: www.imedc.de

IVD Für die Selbstanwendung | **IN-VITRO-DIAGNOSTIKUM**


OHNE CODIERUNG

Verfallsdatum		
Öffnungsdatum		
Lot Nummer LOT		PZN 06426496
Zielwert		Zielbereich
Level 1	mg/dL mmol/L	mg/dL mmol/L
Level 2	mg/dL mmol/L	mg/dL mmol/L

IME-DC GmbH
Fuhrmannstraße 11
D-95030 Hof
Germany
Tel: +49 (0) 9281 / 85 01 6-0
Fax: +49 (0) 9281 / 85 01 6-100
info@imedc.de
Web: www.imedc.de

IME-DC
Int. Medical Equipment Diabetes Care

Handwritten signature

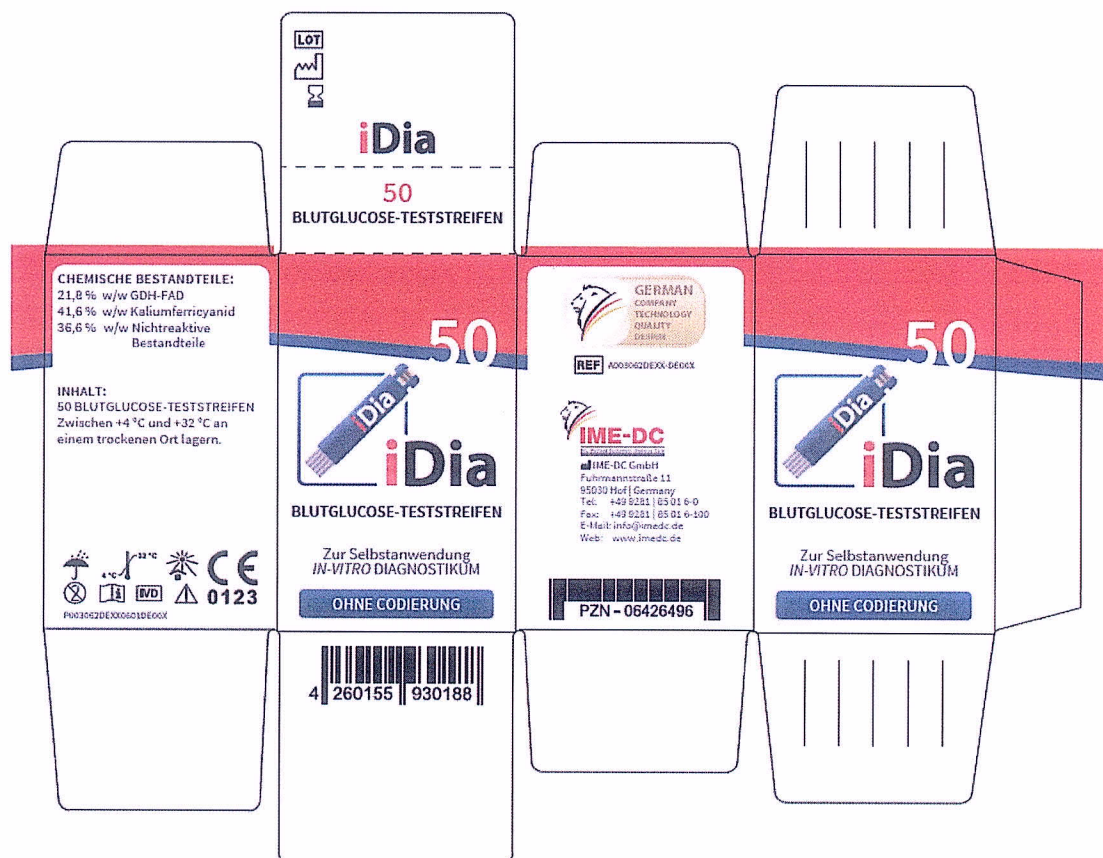

IME-DC GmbH
Fuhrmannstraße 11
D-95030 Hof
Germany
Tel: +49 (0) 9281 / 85 01 6-0
Fax: +49 (0) 9281 / 85 01 6-100
info@imedc.de
Web: www.imedc.de

IME-DC
Int. Medical Equipment Diabetes Care

M. J.


DEXTRA

10

BLUTGLUCOSE-TESTSTREIFEN

Nur zur Anwendung mit
DEXTRA Blutzuckermess-
geräten.

CE
0123



P004040DEXX0402DE00X



IME-DC

Int. Medical Equipment Diabetes Care

IME-DC GmbH
Fuhmannstraße 11
95030 Hof | Germany
Tel: +49 9281 | 85 01 6-0
E-Mail: info@imedc.de
Web: www.imedc.de

IVD Für die Selbstanwendung | IN-VITRO-DIAGNOSTIKUM

OHNE CODIERUNG

Verfallsdatum		
Öffnungsdatum		
Chargencode LOT		
Zielwert		Zielbereich
Level 1	mg/dL mmol/L	mg/dL mmol/L
Level 2	mg/dL mmol/L	mg/dL mmol/L


DEXTRA

25

BLUTGLUCOSE-TESTSTREIFEN

Nur zur Anwendung mit
DEXTRA Blutzuckermess-
geräten.

CE
0123



P004044DEXX0402DE00X



IME-DC

Int. Medical Equipment Diabetes Care

IME-DC GmbH
Fuhmannstraße 11
95030 Hof | Germany
Tel: +49 9281 | 85 01 6-0
E-Mail: info@imedc.de
Web: www.imedc.de

IVD Für die Selbstanwendung | IN-VITRO-DIAGNOSTIKUM

OHNE CODIERUNG

Verfallsdatum		
Öffnungsdatum		
Lot Nummer LOT		
Zielwert		Zielbereich
Level 1	mg/dL mmol/L	mg/dL mmol/L
Level 2	mg/dL mmol/L	mg/dL mmol/L


DEXTRA

50

BLUTGLUCOSE-TESTSTREIFEN

Nur zur Anwendung mit
DEXTRA Blutzuckermess-
geräten.

CE
0123



P004042DEXX0402DE00X



IME-DC

Int. Medical Equipment Diabetes Care

IME-DC GmbH
Fuhmannstraße 11
95030 Hof | Germany
Tel: +49 9281 | 85 01 6-0
E-Mail: info@imedc.de
Web: www.imedc.de

IVD Für die Selbstanwendung | IN-VITRO-DIAGNOSTIKUM

OHNE CODIERUNG

Verfallsdatum		
Öffnungsdatum		
Lot Nummer LOT		PZN 10187198
Zielwert		Zielbereich
Level 1	mg/dL mmol/L	mg/dL mmol/L
Level 2	mg/dL mmol/L	mg/dL mmol/L

IME-DC GmbH
Fuhmannstraße 11
D-95030 Hof
Germany
Tel: +49 (0) 9281 / 85 01 6-0
Fax: +49 (0) 9281 / 85 01 6-100
info@imedc.de
Web: www.imedc.de

IME-DC

Int. Medical Equipment Diabetes Care



IME-DC GmbH
Fuhrmannstraße 11
D-95030 Hof
Germany
Tel: +49 (0) 9281 / 85 01 6-0
Fax: +49 (0) 9281 / 85 01 6-100
info@imedc.de
Web: www.imedc.de

IME-DC
Int. Medical Equipment Diabetes Care

